


超音波プローブに要求される滅菌・消毒のレベル

採卵、胚移植、羊水検査、流産手術は**セミクリティカル**に該当します。

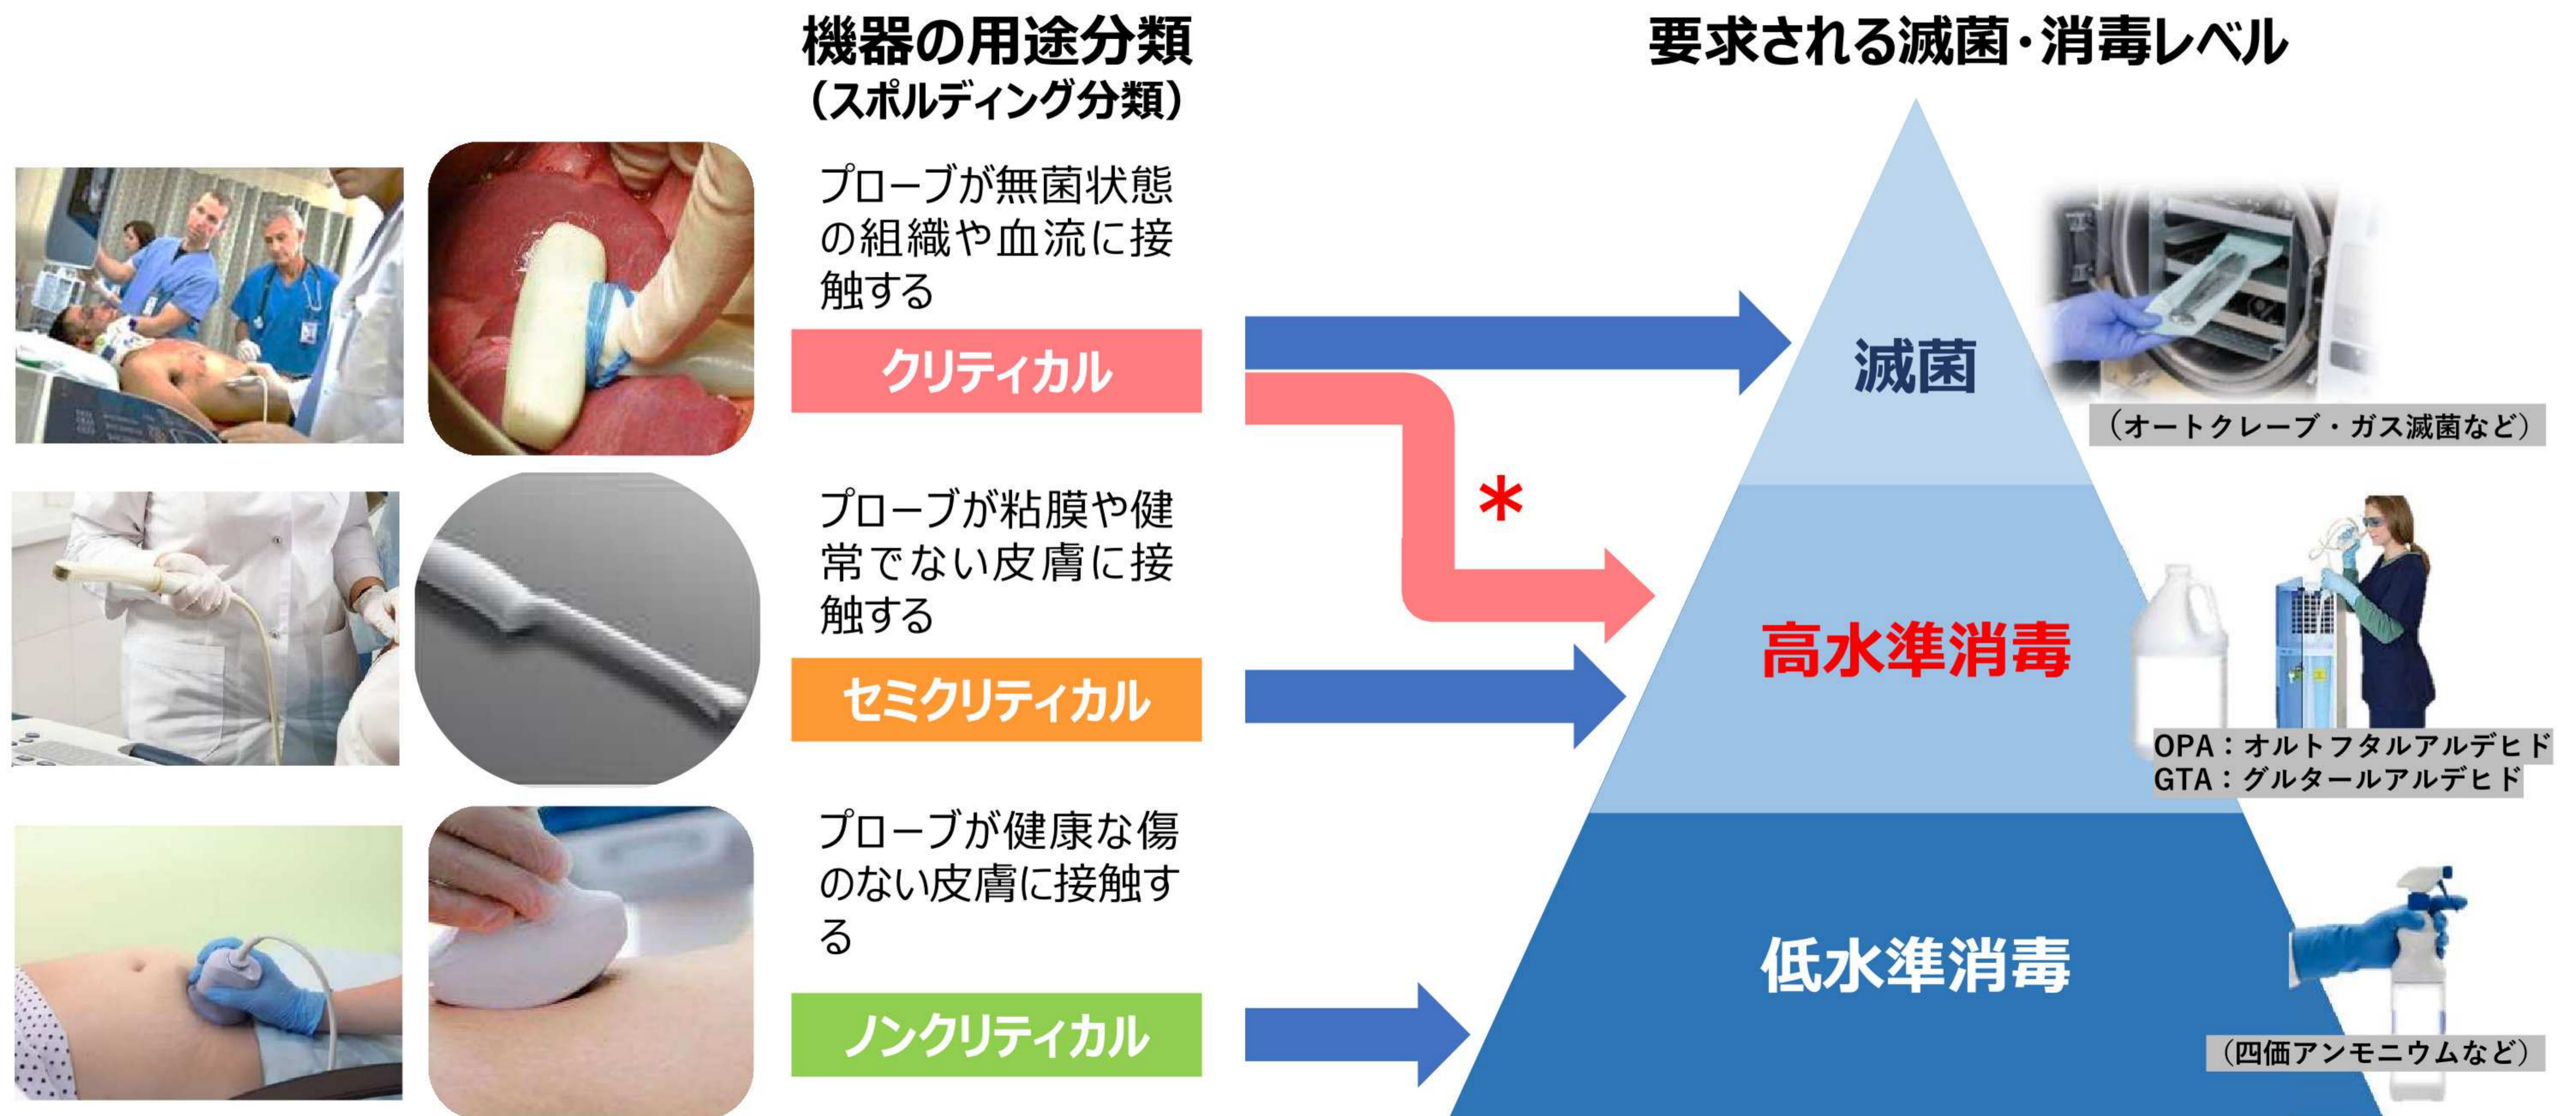

1. Spaulding (1968). Chemical disinfection of medical and surgical materials. Disinfection, sterilization, and preservation.
2. CDC. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities. 2008.

*米国 (CDCなど)をはじめとする国際的なガイドラインでは、クリティカル用途のプローブの滅菌が困難な場合は、高水準消毒のうえでプローブカバーを使用することを承認または推奨している。